8353 ゲニュ ディレクサ

取扱説明書

義肢装具士の方へ

本製品を安全にお取扱いいただくために、使用前に本取扱説明書をお読みください。また、必要な際に参照できるようお手元に保管してください。

装着者の方へ、装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などをご案内ください。

使用目的

『8353 ゲニュ ディレクサ』膝サポーターは、膝関節を安定させるために使用します。本体の内側面と外側面にはアルミニウム製の 2 軸膝ヒンジがそれぞれ挿入されています。本体は前面で開放しますので、装着と脱着が簡単で、装着者に優しい解剖学的なデザインとなっています。本体素材は通気性に優れた吸汗発散素材を採用することで皮膚表面を快適な状態に保ちます。

適応・用途

膝関節障害、軽・中等度の靭帯の緩みに伴う膝の疼痛および不安定性などに使用します。

- ◆ 初期の変形性関節症、関節リウマチ、膝蓋大腿関節障害（例：膝蓋軟骨軟化症、初期の膝蓋大腿関節症）など
- ◆ 前・後十字靭帯などの損傷
- ◆ 外傷後および術後の靭帯・関節の動揺

素材

本体：ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
膝ヒンジ：アルミニウム

装着方法

◆ 初めて装着する際は、必ず医師・義肢装具士のもとで行ってください。必要に応じて膝ヒンジの形状を調整してください。

1）本体前面の面ファスナーを開きます。
2）本体前面の膝蓋骨開放部が膝蓋骨に合うように確認します。
3）本体下腿部の面ファスナーを閉じ、その後大腿部の面ファスナーを閉じます。本体素材の伸縮性を利用し、両端を引っ張りながら面ファスナーを留めます。
4）下腿部のベルトストラップを留めます。その後大腿部のベルトストラップを留めます。

全体を強く締めすぎないよう注意し、正しく装着されていることを確認してください。

注意事項

◆ 適応方法に関してのお問い合わせやご相談は、医師または義肢装具士にご連絡ください。
◆ 本製品は不燃性ではありません。本体を火気に近づけたり、120℃を超える場所に放置したりしないでください。
◆ 本体の調整は、医師または義肢装具士のみが行えます。
◆ 本製品の機能変更、または機能が損なわれる加工は行わないでください。製品は本来の目的及び、適用範囲にのみご使用ください。
◆ ネオプレン素材を使用している製品に関して、4 時間を超える連続使用は避けてください。
◆ その他の素材を用いている製品の使用に関して、医師または義肢装具士からの指示などが無い限り、8 時間を超える連続使用は避けてください。
◆ 使用されている素材に対しアレルギーがある方は、製品を使用する前に医師にご相談ください。本製品に使用されている素材の内容は、上記に記載されています。
◆ 本製品を廃棄する際には、各自治体の廃棄区分に従ってください。

お手入れの方法

◆ 本体より膝ヒンジを取り外してください。
◆ すべての面ファスナーを閉じてください。
◆ 洗濯の際には、40℃以下の水と中性洗剤を使用し、手洗い、陰干しをしてください。
◆ 陰干しする際、製品のシワを伸ばしてください。塩素系漂白剤、洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロン、ドライクリーニングなどの使用はしないでください。
◆ 取り外した膝ヒンジを本体カバーに挿入します。ヒンジに刻印された番号が表から見えるように入れてください。（図 3 参照）

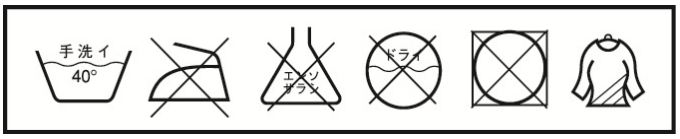

お問い合わせ窓口：

輸入元：オットーボック・ジャパン株式会社
〒108-0023　東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F